2010 年 3 月 9 日　（第 1 版）　　承認番号　22100BZX00640000

機械器具 8 保育器

高度管理医療機器 定置型保育器 JMDN 36025000

特定保守管理医療機器

ジラフ インキュベータ

(ジラフ Exam ライト)

【警告】

ライトを長時間使用しないこと。
[新生児の目を傷める恐れがあるため]

【禁忌・禁止】

本装置を使用するにあたり改造は絶対に行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

構造・構成ユニット

1. 形状及び構造

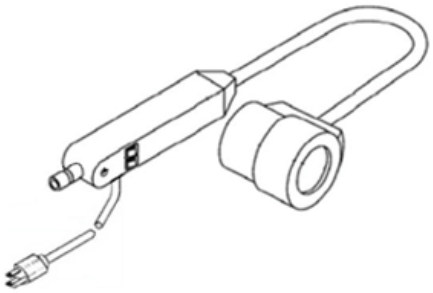

・ ライトの全長：　1m
・ 電源ケーブル長：3m

【使用目的、効能又は効果】

使用目的(ジラフインキュベータ)

本装置は、新生児が外的生活に順応可能となるまでの間、適切な温湿度環境下に患児を保育することを目的として病棟、診療科内に維持される定置型保育器の構成品である。

【品目仕様等】

・ ライト部分：　50W(ハロゲンランプ)
・ 色温度：　3400K
・ 電球寿命：　約 3000 時間
・ 角度調節可能

【操作方法又は使用方法等】

本装置は、新生児の診療及び治療時に、ジラフインキュベータの DT レールに取り付けて使用する照明器である。
ライト部分は 50W のハロゲンランプを使用し、グースネック型の柄により角度が調節可能である。
Exam ライトに付属されている取扱説明書を熟読し、理解した上で取り扱うこと。

設置方法

1. インキュベータの DT レールに固定し、新生児から 50cm 以上離して設置すること。
取付に関する詳細は、Exam ライトの取扱説明書「取り付け調整」の章を参照すること。
2. 以下の点について確認すること。
(1)取り付け部分はマットレスから上部に 15cm 以上離して設置すること。
(2)ランプにヒビなどの破損が無いこと。
(3)DT レールにしっかりと取り付けられていること。
(4)ネック部分の動きが柔軟に動くこと。

使用方法

1. トランスボックスの電源スイッチを ON にする。
2. 調光スイッチにて、ライトの強弱の調整を行う。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. ライトは新生児に対する熱源となるので、新生児から十分に距離を確保し使用すること。
使用中は新生児から目を離さないこと。
2. ランプヘッドが新生児の上に直接位置しないように取り付けること。
3. 放射熱源の真下には Exam ライトを設置しないこと。
熱が新生児に伝わらず、Exam ライトを破損(ランプ上部及びプラスチック部分)する恐れがある。
4. 可燃性のあるガス・物質の近くで使用しないこと。
5. ライトのレンズが破損しているときは速やかに交換すること。
6. 衝撃や衝突、ライトがまだ発熱している時に動かしたりすると、ランプの寿命が短くなることがあるため、移動などを行う場合は 10 分以上ライトを冷ましてから行うこと。
7. 医家向け医療機器であるため、医師による使用及び指示によって使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

1. 保管条件
・ 周囲温度：　-20～60℃
・ 相対湿度：　包装含め結露なきこと。
2. 保管環境及び保管の注意
(1)保存袋に入れて保管すること。
(2)水気のある場所での保管は避けること。
(3)ほこりの多い場所での保管は避けること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 破損や損傷、その他ダメージが無いかチェックすること。
2. DT レールにしっかり固定されていることを確認すること。
3. 清掃する場合は湿った布を使用し、洗浄液はエチル又はイソプロピルアルコールを使用すること。
(1)ライト及びレンズ部分は一般的なガラス洗浄剤を使用することができる。
(2)研磨剤が含まれた洗浄剤は使用しないこと。
4. ライトの交換については、取扱説明書「電球の交換」を参照し交換を行うか、当社認定のサービス担当者に依頼すること。
(1)ライトは指定されたハロゲンランプを取り付けること。
(2) 交換の際は、ハロゲンランプが冷えていることを確認すること。

【包装】

1 台単位で梱包

5371768

取扱説明書を必ずご参照ください。

GE Healthcare Japan Corporation

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：
GEヘルスケア・ジャパン株式会社
住所： 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

連絡先：カスタマーコールセンター
住所： 〒192-0033 東京都八王子市高倉町 67-4
電話： 0120-055-919
FAX： 042-648-2905

製造業者： オメダメディカル
(Ohmeda Medical)
国名： アメリカ合衆国

社内部品番号： 5371768

販売業者(代理店)の連絡先：
エア・ウォーター株式会社 医療カンパニー 医療機器部
住所： 〒105-0001
東京都港区虎ノ門 3 丁目 18 番 19 号
電話： 03-3578-7810

取扱説明書を必ずご参照ください。